

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 このたび、下記検査項目におきましては、下記実施日より
 群馬臨床検査センターにて測定することになりましたので、
 ご案内申し上げます。

敬白

記

■変更実施日 2016年7月17日（日）ご依頼分より

■変更項目

案内書 掲載頁	項目 コード	検査項目名称
80	0082	尿中アルブミン
80	1082	尿中アルブミン（クレアチニン換算値）

■変更内容



変更内容	新	現
測定場所	群馬臨床検査センター	エスアールエル MUQS ラボラトリー
所要日数	1～2日	2～4日

尿中アルブミン

尿中アルブミン (クレアチニン換算値)



SRLvsAU5400

SRLvsAU5400

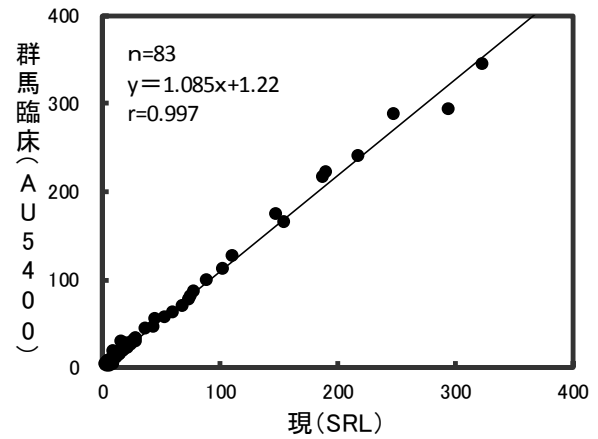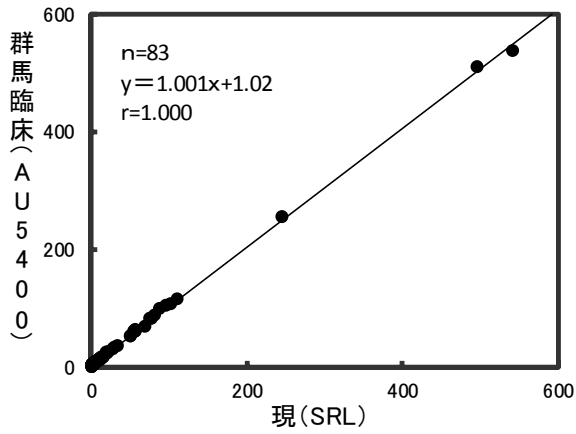



SRLvsAU5800

SRLvsAU5800

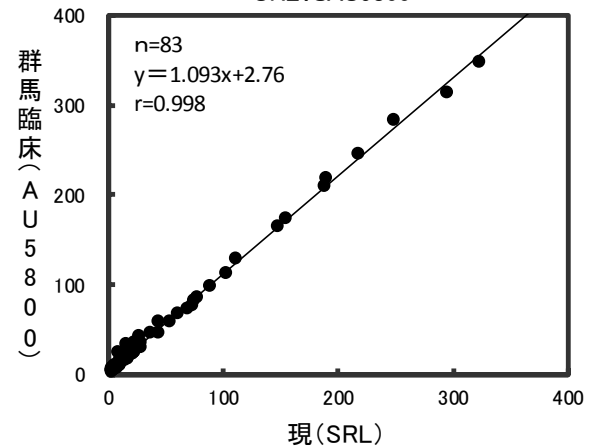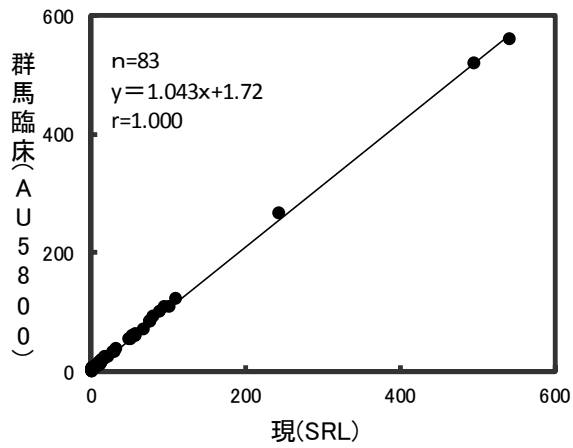

AU5400vsAU5800

AU5400vsAU5800

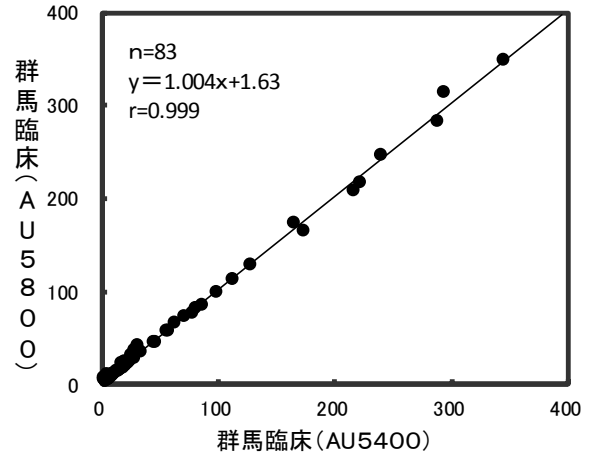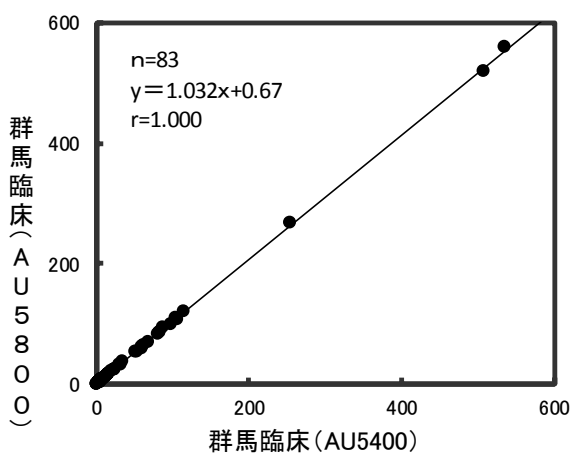

社内の生化学検査は **AU5400** 及び **AU5800** の2機種にて測定を実施しています。