

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。  
このたび下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内いたします。  
何卒ご了承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬白

### 記

■ 実施日 2018年6月1日（金）ご依頼分より

■ 変更項目

検査項目	バルプロ酸
	ジゴキシン
	テオフィリン

■ 変更理由


測定機器の変更の為

## ● バルプロ酸

本検査におきまして、検査方法を変更させていただきます。

項目コード	検査項目	変更内容	新	現
0392	バルプロ酸	検査方法	酵素法	CLIA 法
		基準値 (単位) (治療濃度範囲)	50~100 ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )	50~100 ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )
		測定範囲	1~150 ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )	1~150 ( $\mu\text{g}/\text{mL}$ )
		検体量	血清 0.2 mL	血清 0.2 mL
		測定場所	エスアールエル 北関東検査センター	エスアールエル 北関東検査センター

### ▼現法と新法の比較

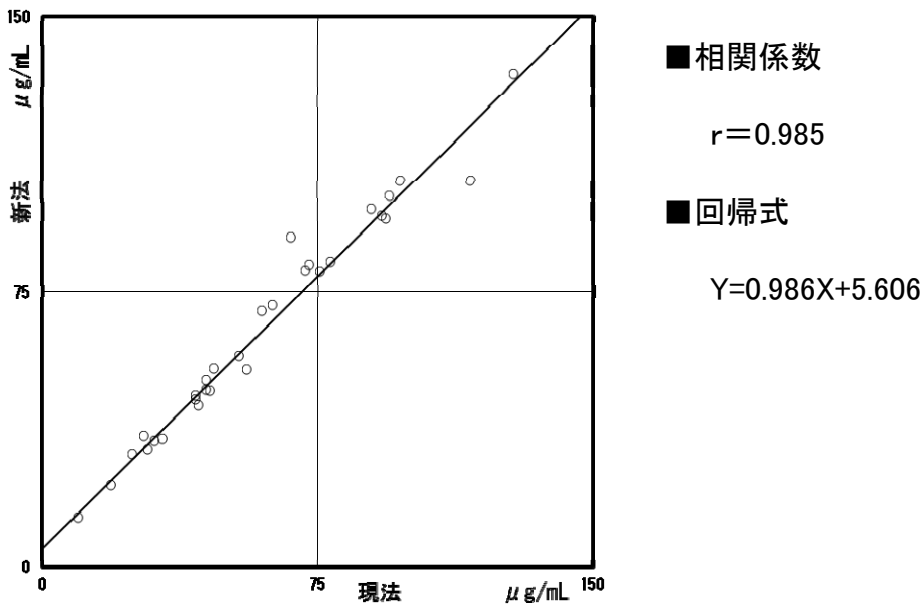


## ● シゴキシン

本検査におきまして、検査方法を変更させていただきます。

項目コード	検査項目	変更内容	新	現
0661	シゴキシン	検査方法	酵素法	CLIA 法
		基準値 (単位) (治療濃度範囲)	0.9~2.0 (ng/ mL)	0.80~2.00 (ng/ mL)
		測定範囲	0.3~5.0 (ng/ mL)	0.10~5.00 (ng/ mL)
		検体量	血清 0.3 mL	血清 0.3 mL
		測定場所	エスアールエル 北関東検査センター	エスアールエル 北関東検査センター

### ▼現法と新法の比較

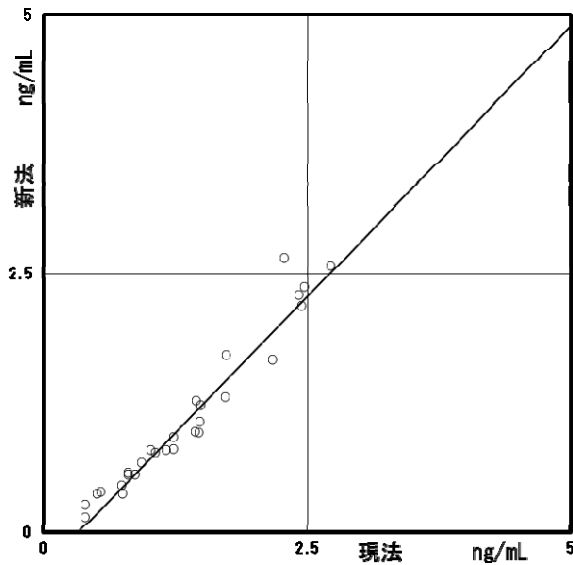

■相関係数

$$r=0.972$$

■回帰式


$$Y=1.050X-0.334$$

## ● テオフィリン

本検査におきまして、検査方法を変更させていただきます。

項目コード	検査項目	変更内容	新	現
0673	テオフィリン	検査方法	酵素法	CLIA 法
		基準値 (単位) (治療濃度範囲)	10.0~20.0 (μg/ mL)	10.0~20.0 (μg/ mL)
		測定範囲	2.5~40.0 (μg/ mL)	0.5~40.0 (μg/ mL)
		検体量	血清 0.2 mL	血清 0.2 mL
		測定場所	エスアールエル 北関東検査センター	エスアールエル 北関東検査センター

### ▼現法と新法の比較

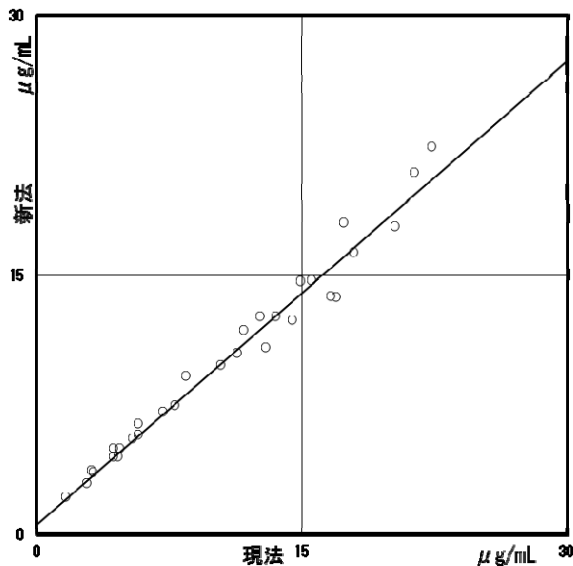

■相関係数

$$r=0.987$$

■回帰式

$$Y=0.893X+0.629$$

お問い合わせ：027-265-6498 検査部：黒崎